

## PORT-A-CATH® II Sistemas Implantables de Acceso




### El poder de dos materiales en un puerto

Descubra la poderosa combinación de dos materiales – polisulfona y titanio juntos en un puerto.

- El septum es capturado en titanio para brindar la alta compresión necesaria para la retención y estabilidad de la aguja, y retroalimentación táctil positiva
- Disponible con catéteres de silicona y de poliuretano PolyFlow®
- Puerto de polisulfona no ferrosa/titanio es seguro para su uso con imagenología de diagnóstico, incluyendo IRM y TC
- La carcasa de polisulfona tiene un anillo de septum redondeado bien definido para facilitar el acceso al septum
- Huecos abiertos para sutura diseñados para estabilizar el puerto

**Deltec**<sup>TM</sup>

# PORT-A-CATH® II Sistemas Implantables de Acceso

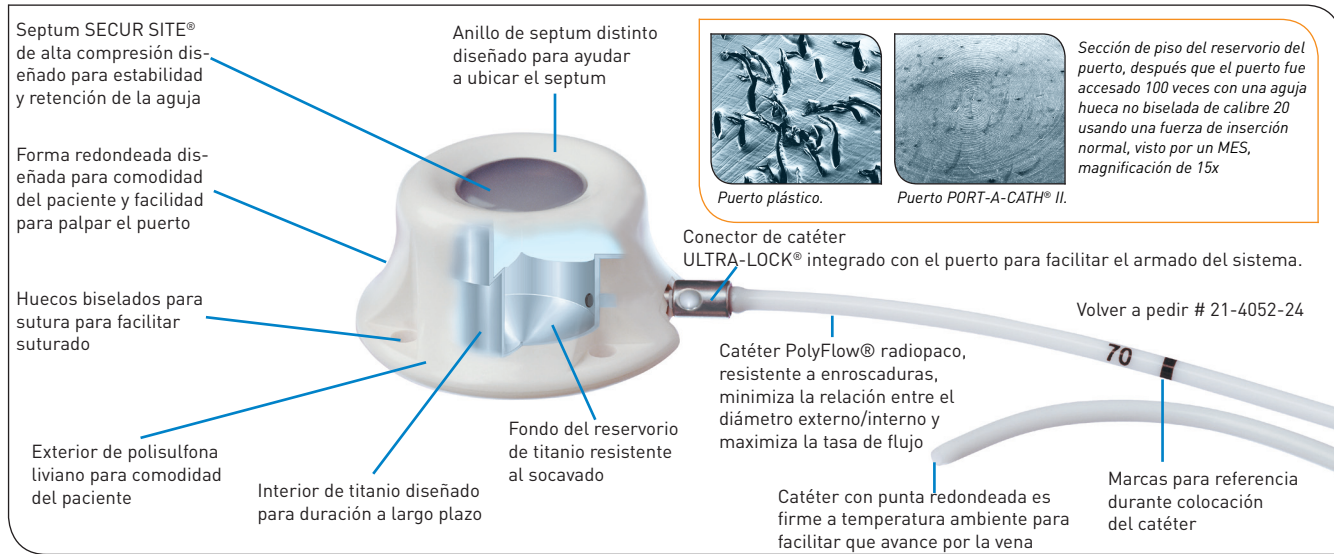

## ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Puerto							Catéter									
	Material	Base	Altura	Peso	Diámetro del Septum	Conector	Material	DI	DE	French	Longitud	Tamaño de Introdutor	Configuración	Número de Pedido		
Lumen único	Polisulfona/ Titanio	30.5mm	14.7 mm	10 g	11.4 mm	CATH-SHIELD®	Silicona	1.0 mm	2.8 mm	8.4 Fr	76cm	9 Fr	Desarmado	Kit: 21-4050-24 Bandeja: 21-4051-24		
							ULTRA-LOCK® SlideLock®	Poliuretano	1.0 mm	1.9 mm	5.8 Fr	76cm	6 Fr	Desarmado	Kit: 21-4052-24 Bandeja: 21-4053-24	
								ULTRA-LOCK® PolyFlow®	Poliuretano	1.6 mm	2.6 mm	7.8 Fr	76cm	8.5 Fr	Desarmado	Kit: 21-4054-24 Bandeja: 21-4055-24
									Poliuretano	1.0 mm	1.9 mm	5.8 Fr	76cm	6 Fr	Desarmado	Kit: 21-4064-24 Bandeja: 21-4065-24
Lumen único Low Profile™	Polisulfona/ Titanio	25mm	11.5 mm	4.8 g	9.5 mm	ULTRA-LOCK®	Poliuretano	1.0 mm	1.9 mm	5.8 Fr	76cm	6 Fr	Desarmado	Kit: 21-4082-24 Bandeja: 21-4083-24		
							ULTRA-LOCK® SlideLock®	Poliuretano	1.6 mm	2.6 mm	7.8 Fr	76cm	8.5 Fr	Desarmado	Kit: 21-4084-24 Bandeja: 21-4085-24	
								ULTRA-LOCK® PolyFlow®	Poliuretano	1.0 mm	2.2 mm	6.6 Fr	76cm	7 Fr	Desarmado	Kit: 21-4070-24 Bandeja: 21-4071-24
									Poliuretano	1.4 mm	3.2 mm	9.6 Fr	76cm	10 Fr	Desarmado	Kit: 21-4072-24 Bandeja: 21-4073-24
Lumen doble	Polisulfona/ Titanio	50mm x 30mm	16 mm	24 g	11.4 mm	CATH-SHIELD®	Silicona	1.1 mm	3.4 mm	10.2 Fr	76cm	11 Fr	Desarmado	Kit: 21-8050-24 Bandeja: 21-8052-24		
							ULTRA-LOCK® SlideLock®	Silicona	1.1 mm	3.4 mm	10.2 Fr	76cm	11 Fr	Desarmado	Kit: 21-8050-24 Bandeja: 21-8052-24	
Lumen doble Low Profile™	Polisulfona/ Titanio	38.7mm x 23.5mm	11 mm	11 g	9.5 mm	WING-LOCK®		Poliuretano	1.0 mm	2.2 mm	6.6 Fr	76cm	7 Fr	Desarmado	Kit: 21-8065-24 Bandeja: 21-8066-24	
							WING-LOCK® PolyFlow®	Poliuretano	1.4 mm	3.2 mm	9.6 Fr	76cm	10 Fr	Desarmado	Kit: 21-8067-24 Bandeja: 21-8068-24	

† Nominal

Los kits incluyen: puerto, catéter, aguja recta PORT-A-CATH®, aguja roma [excepto sistemas preconectados], selector de vena.

Las bandejas incluyen: puerto, catéter, aguja recta PORT-A-CATH®, aguja roma [excepto sistemas preconectados], selector de vena, aguja introductora de pared extra fina calibre 18, alarmes(s) guía en "J", conjunto dilatador de vaso/introductor de funda, aguja PORT-A-CATH® de 90°, Aguja(s) de seguridad GRIPPER PLUS®, 2 jeringas, instrumento de tunelización, y dispositivo(s) Point-Lok®.

LOS DETALLES SUMINISTRADOS EN ESTE FOLLETO SON CORRECTOS EN EL MOMENTO DE SER IMPRESOS. LA COMPAÑÍA SE RESERVA EL DERECHO DE MEJORAR EL EQUIPO PRESENTADO.

Para mayor información contacte a su distribuidor de Smiths Medical.

### Smiths Medical International Ltd

Hythe, Kent Ct21 6JL UK

Tel: +44 (0)1303 260551 Fax: +44 (0)1303 266761

www.smiths-medical.com

### Smiths Medical, part of the global technology business Smiths Group

PORT-A-CATH, GRIPPER PLUS, Point-Lok, SECUR SITE, PolyFlow, ULTRA-LOCK, CATH-SHIELD, SLIDE-LOCK, WING-LOCK, y la marca de diseño de Smiths son marcas comerciales de la familia de compañías Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca comercial se encuentra registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos y de ciertos países.

©2006 familia de compañías de Smiths Medical. Todos los derechos reservados. 9/06 19400 Literature No. LIT/0019400

smiths medical